



savyonDIAGNOSTICS

96
192


REF A262-01M

REF B262-01M

SeroMP™ IgM

Ensayo Inmunoenzimático en fase sólida (ELISA) para la determinación semi-cuantitativa de anticuerpos IgG específicos frente a *Mycoplasma pneumoniae* en suero humano

IVD



Exclusivamente para uso profesional

MP

CE

Sero MP^{MR} IgM

Aplicaciones

El ensayo SeroMP^{MR}-IgM es un enzimoimmunoensayo semicuantitativo en fase sólida (ELISA) para la determinación de anticuerpos IgM específicos frente a *Mycoplasma pneumoniae* en suero humano.

Este ensayo posibilita el diagnóstico temprano con una sola muestra de suero, por medio de determinación de anticuerpos IgM.

Para uso en diagnóstico *In Vitro*.

Introducción

M. pneumoniae es un agente etiológico común de neumonía adquirida en la comunidad, a menudo caracterizado por una manifestación gradual de síntomas con dolor de cabeza, fiebre, malestar y más frecuentemente con tos seca. *M. pneumoniae* se presenta en grupos de todas las edades. Sin embargo, es más común en las dos primeras décadas de la vida y raramente se presenta en niños menores de cuatro años. Se ha publicado que *M. pneumoniae* de hasta un 30% de todos los casos de neumonía(1).

M. pneumoniae ha sido también asociada con enfermedades no respiratorias como la meningitis, encefalitis, pancreatitis, pérdida de la capacidad auditiva neurosensorial y síndrome agudo de tallo cerebral (2).

Debido a su común ocurrencia, se debe considerar una posible infección por *M.pneumoniae* en todos los casos de neumonía; pero teniendo en cuenta que estos mismos síntomas aparecen también en infecciones por diferentes agentes, se requieren herramientas adicionales de diagnóstico, como la serología (3).

La técnica de ELISA es sensible y específica permitiendo la determinación diferencial de anticuerpos específicos del isotipo IgG, IgA e IgM (4).

Los anticuerpos IgM específicos frente a *M. pneumoniae* aparecen al comienzo de la infección, alcanzando el pico de máxima expresión entre la primera y la cuarta semana, declinando a los pocos meses hacia niveles sin valor diagnóstico (5). Debido a la aparición temprana de anticuerpos IgM y a su vida media relativamente corta, su detección permite el diagnóstico de la infección aguda utilizando una única muestra de suero. Los pacientes jóvenes tienden a tener niveles de IgM más elevados que los adultos (6). Los niveles de IgG incrementan más lentamente que los de IgM, pero permanecen elevados durante mucho más tiempo; por lo que un incremento significativo entre dos muestras consecutivas, extraídas al menos con dos semanas de diferencia, puede indicar una infección reciente o una re-infección incluso en ausencia de IgM. Los anticuerpos IgA presentan niveles más elevados en pacientes con edad más avanzada (5) por lo que puede resultar más útil que la IgM para el diagnóstico de infección actual

en pacientes adultos (6).


El ensayo de ELISA semicuantitativo para la detección de IgG, IgA e IgM, desarrollado por Savyon® Diagnostics Ltd. permite realizar el seguimiento del cambio en los títulos de los anticuerpos en el suero humano. El antígeno utilizado en el ensayo SeroMPMR es una preparación de la membrana de *M.pneumoniae*, que contiene la proteína membranal P1, considerada como el principal inmunógeno (7,8,9,10,11).

El ensayo SeroMPMR permite la detección temprana y segura de anticuerpos IgG, IgA e IgM frente a *M.pneumoniae*.

Principio del Ensayo

- La microplaca del kit SeroMPMR está recubierta con la fracción purificada de las proteínas de membrana de *M.pneumoniae*.
 - El suero a testar se diluye y se incuba en la microplaca de SeroMPMR. En este paso, los anticuerpos específicos frente a *M.pneumoniae* se unen a los antígenos inmovilizados.
 - Los anticuerpos no específicos, se remueven por un paso de lavado.
 - Se añade anti IgM humana marcada con peroxidasa (HRP). En este paso, el conjugado-HRP se une al complejo antígeno-anticuerpo previamente unido a la placa.
 - El conjugado sin unir, se elimina por un paso de lavado.
 - Tras la adición del substrato-TBM se hidroliza por acción de la peroxidasa, generándose un producto de la reacción (substrato reducido) que confiere color azul a la solución.
 - Tras la adición de la solución de parada el color azul vira a amarillo, debiendo leerse en un lector de ELISA a longitud de onda de 450/620nm.
 - La absorbancia detectada, es proporcional al nivel de anticuerpos específicos que se han unido a los antígenos que recubren la placa.
-

Procedimiento del Ensayo

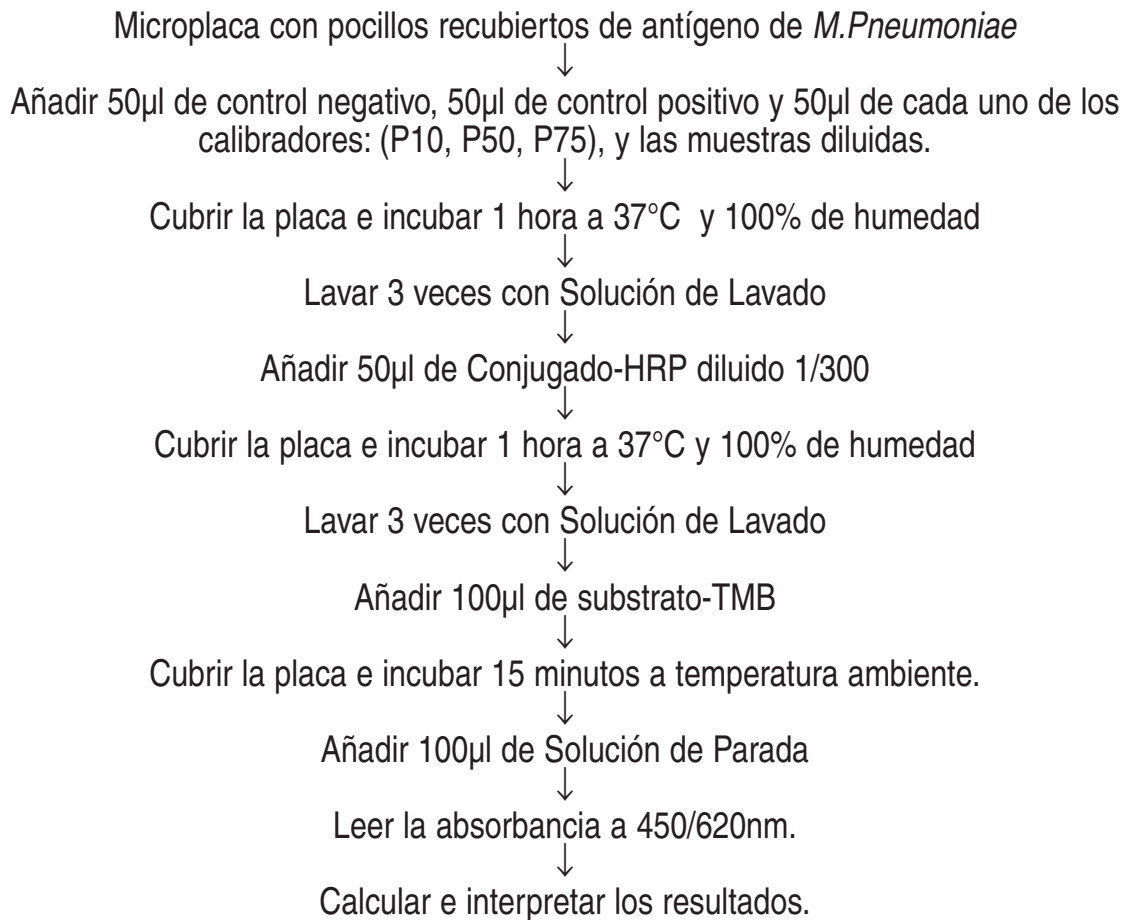

Componentes del ensayo

Ensayo para 96 determinaciones

Ref: A262-01M

1. **Microplaca recubierta con antígeno de *M.pneumoniae*:** 96 pocillos divisibles (8x12) recubiertos con antígenos de *M.pneumoniae*, incluida en una bolsa de aluminio que contiene desecante.
1 placa
2. **Solución de Lavado concentrada (20X):** Solución de PBS-Tween 20
1 frasco, 100ml
3. **Diluyente del suero - IgM (rojo):** Anti-IgG humana en tampón, listo para usar. Contiene menos de 0.05% Proclin como preservativo.
1 frasco, 60ml
4. **Diluyente del Conjugado (verde):** Solución lista para usar. Contiene Proclin como conservante, a concentración inferior a 0.05%
1 frasco, 40ml
5. **Control Positivo:** Suero humano positivo a la presencia de anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml

6. **Control Negativo:** Suero humano negativo a la presencia de anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
7. **Calibrador P10:** Suero humano con positividad baja para anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene 10BU/ml (unidades arbitrarias de unión). Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
8. **Calibrador P50:** Suero humano con positividad media para anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene 50BU/ml (unidades arbitrarias de unión). Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
9. **Calibrador P75:** Suero humano con positividad alta para anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene 75BU/ml (unidades arbitrarias de unión). Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
10. **Conjugado-HRP concentrado (300X):** Anti IgM humana (específica de cadena μ) conjugada con peroxidasa de rábano. Contiene Proclin como conservante (<0.05%)
1 frasco, 0.2ml
11. **Substrato-TMB:** Solución, lista para usar, que contiene 3,3',5,5' tetrametilbencidina como cromógeno y peróxido como sustrato.
1 frasco, 14ml
12. **Solución de Parada:** Solución lista para usar, que contiene H₂SO₄ 1M.
1 frasco, 15ml
13. **Tapa para la microplaca:** **1 unidad**
14. **Manual de Instrucciones:** **1**

Ensayo para 192 determinaciones

Ref: B262-01M

1. **Microplaca recubierta con antígeno de *M.pneumoniae*:** 96 pocillos divisibles (8x12) recubiertos con antígenos de *M. pneumoniae*, incluida en una bolsa de aluminio que contiene desecante.
2 placas
2. **Solución de Lavado concentrada (20X):** Solución de PBS-Tween 20
2 frascos, 100ml/ frasco
3. **Diluyente del suero – IgM (rojo):** Anti-IgG humana en tampón, listo para usar. Contiene menos de 0.05% Proclin como preservativo.
1 frasco, 60ml
4. **Diluyente del Conjugado (verde):** Solución lista para usar. Contiene Proclin como conservante, a concentración inferior a 0.05%
1 frasco, 80ml
5. **Control Positivo:** Suero humano positivo a la presencia de anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml

6. **Control Negativo:** Suero humano negativo a la presencia de anticuerpos IgM frente a *M. pneumoniae*. Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
7. **Calibrador P10:** Suero humano con positividad baja para anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene 10BU/ml (unidades arbitrarias de unión). Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
8. **Calibrador P50:** Suero humano con positividad media para anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene 50 BU/ml (unidades arbitrarias de unión). Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
9. **Calibrador P75:** Suero humano con positividad alta para anticuerpos IgM frente a *M.pneumoniae*. Contiene 75BU/ml (unidades arbitrarias de unión). Contiene Proclin (<0.05%) y azida sódica (<0.1%) como conservantes.
1 frasco, 2.0ml
10. **Conjugado-HRP concentrado (300X):** Anti IgM humana (específica de cadena μ) conjugada con peroxidasa de rábano. Contiene Proclin como conservante (<0.05%)
1 frasco, 0.2ml
11. **Substrato-TMB:** Solución, lista para usar, que contiene 3,3',5,5' tetrametilbencidina como cromógeno y peróxido como sustrato.
1 frasco, 24ml
12. **Solución de Parada:** Solución lista para usar, que contiene H₂SO₄ 1M.
1 frasco, 30ml
13. **Tapa para la microplaca:** **2 unidades**
14. **Manual de Instrucciones:** **1**

Material requerido que no se proporciona:

1. Tubos de ensayo limpios para la dilución del suero de los pacientes.
2. Tubos de plástico desechables para la dilución del conjugado-HRP concentrado.
3. Micropipetas ajustables y pipeta multicanal (rangos 5-50, 50-200, 200-1000 μ l) y puntas desechables.
4. Un frasco calibrado para un litro.
5. Una probeta calibrada para 50ml
6. Un frasco lavador
7. Papel absorbente
8. Agitador tipo vortex.
9. Baño de agua con tapadera para 37°C, o cámara húmeda situada dentro de un incubador a 37°C.
10. Lector de ELISA con filtros para 450 y 620nm.
11. Agua destilada o doblemente desionizada.

Medidas de Seguridad

Para su utilización en el diagnóstico *In Vitro*

1. Este kit contiene suero humano que ha sido testado por técnicas aprobadas por la FDA y CE con resultado negativo para el antígeno del VHB y para anticuerpos frente a VHC y VIH 1 y 2. Ya que no se conoce ningún método que sea capaz de ofrecer una garantía completa de que los productos derivados de la sangre humana no transmiten infección, todos los componentes de la sangre humana que se suministran en este kit deben manipularse como si fueran muestras de sangre o de suero potencialmente infecciosas; de acuerdo con las recomendaciones publicadas en el R.D. 664/1997 sobre Protección de los Trabajadores contra Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos en el Trabajo (manual CDC/NIH "Biosafety in Micro Biological and Biomedical Laboratories, 1988").
2. La solución de substrato-TMB, contiene un material irritante para la piel y para las membranas mucosas. Evitar el contacto directo.
3. Todos los componentes del ensayo, se han calibrado y examinado para cada lote. No se recomienda mezclar reactivos de diferentes lotes, ya que podría afectar a los resultados.
4. El ácido sulfúrico diluido (H_2SO_4 1M) es un agente irritante para los ojos y para la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y solicitar atención médica.

Almacenamiento y vida media de los reactivos

1. Todos los componentes que se suministran, deberán almacenarse de 2-8°C. Los frascos de reactivo sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el kit. La exposición de los componentes del kit, durante algunas horas a temperatura ambiente, no provoca ninguna alteración sobre los reactivos.
NO CONGELAR!
2. El kit caduca a los 90 días de haber sido abierto.
3. Las filas de pocillos sin usar, deben guardarse en la bolsa de aluminio con el desecante en su interior, enrollando la orilla abierta y sellando con cinta adhesiva a todo lo largo, procurando que la bolsa quede perfectamente sellada.
4. Durante el almacenamiento en frío, pueden formarse cristales en la solución de lavado concentrada 20x, siendo esto una reacción perfectamente normal. Volver a disolver los cristales, calentando la solución a 37°C antes de su dilución. La solución una vez diluida, puede almacenarse de 2-8°C hasta 21 días.

Preparación de las muestras

Preparar los sueros a partir de muestras extraídas asépticamente por técnicas estándar. No deben utilizarse muestras de suero que hayan sido inactivadas por calor. No se recomienda la utilización de sueros lipémicos, turbios o contaminados. La presencia de partículas o precipitados en el suero, puede conducir a resultados erróneos. Se recomienda depurar las muestras por centrifugación o filtración antes de comenzar con el ensayo.

Almacenamiento

Las muestras deberían almacenarse de 2-8°C y ensayarse dentro de los siguientes 7 días (se recomienda añadir azida sódica al 0.1%). Si se precisan periodos prolongados de almacenamiento, alicuotar los sueros y guardar a -20°C, evitando ciclos repetidos de congelación y descongelación.

Procedimiento del Ensayo - Manual

Protocolo de automatización disponible bajo petición

A. Preparación de los Reactivos

1. Todos los reactivos y las muestras deben alcanzar la temperatura ambiente, antes de comenzar con el ensayo. Mezclar bien los calibradores (P10, P50, P75), el control negativo, control positivo y las muestras de suero, antes de su utilización.
2. Calcular el número de muestras a ensayar. Además de las muestras, en cada ensayo se debe incluir: un pocillo para el blanco, un pocillo para el control negativo, control positivo y tres pocillos para los calibradores.
3. Extraer la microplaca cortando la bolsa de aluminio por el extremo cercano al cierre. Colocar el número de filas necesarias (según el número de muestras a testar) en el soporte para la microplaca de 96 pocillos.
4. Diluir 1/20 la solución de lavado concentrada con agua destilada o doblemente desionizada. Por ejemplo, para preparar un litro de solución de lavado, añadir 50ml de la solución de lavado concentrada a 950ml de agua destilada o doblemente desionizada.

B. Incubación de las muestras de suero y de los controles

5. Diluir cada uno de los sueros de los pacientes 1:105 con el diluyente de suero proporcionado, como se indica a continuación: Añadir 10µl del suero del paciente a 200µl del diluyente del suero (1/21); realizar una dilución posterior añadiendo 25µl de la dilución 1/21 a 100µl del diluyente del suero.

Nota: El diluyente de suero contiene anti-IgG humana para el retiro de anticuerpos IgG de suero humano.

6. Añadir a pocillos separados 50µl de muestra en blanco (diluyente del suero), del control negativo, control positivo de los tres calibradores (P10, P50, P75), y de las muestras de suero diluidas 1:105.
7. Cubrir las filas con una tapa e incubar durante 1 hora en una cámara húmeda a 37°C.
8. Eliminar el líquido contenido en los pocillos.
9. **Lavado:** Llene completamente cada pocillo con solución de lavado (300-350µl) y descarte el líquido; repita este paso dos veces más, para un total de tres lavados.
10. Secar las filas y el soporte, invirtiéndolo sobre papel absorbente y golpeando suavemente.

C. Incubación con el conjugado

11. La dilución de trabajo del anticuerpo anti IgM humana conjugado con peroxidasa, deberá realizarse un poco antes de su utilización. Diluir 1/300 el anticuerpo concentrado anti IgM humana conjugado con peroxidasa, con diluyente del

- conjugado. Por ejemplo: Para dos filas de pocillos, preparar un mínimo de 3ml de conjugado como se indica a continuación: Mezclar 10µl del anticuerpo concentrado anti IgM humana conjugado con peroxidasa con 3ml del diluyente del conjugado.
12. Añadir 50µl del conjugado diluido a cada uno de los pocillos.
 13. Cubrir las filas con una tapa e incubar durante 1 hora a 37°C en una cámara húmeda.
 14. Eliminar el líquido y lavar según se indica en los pasos 9-10.

D. Incubación con el substrato-TMB.

15. Añadir 100µl del substrato-TMB a cada pocillo, cubrir las filas con una tapa e incubar a temperatura ambiente durante **15 minutos**.
16. Parar la reacción añadiendo 100µl de solución de parada (H₂SO₄ 1M) a cada pocillo.

E. Determinación de los Resultados.

17. Determinar la absorbancia a 450/620nm y grabar los resultados. La determinación no deberá exceder en más de 30 minutos a la finalización de la reacción cromogénica.

Advertencia: *Debe eliminarse cualquier burbuja de aire antes de la lectura. Debe limpiarse cuidadosamente el fondo de la placa de ELISA.*

Validación del ensayo

Para que el ensayo se considere como válido, deben cumplirse los siguientes criterios de validación. En el caso de que no se cumplieren, el ensayo no debería considerarse como válido y debería repetirse.

1. O.D. _{P75} > **0.9**
2. Relación: O.D. _{P10} / O.D. _{CN} > **1.5**
3. Relación: O.D. _{P50} / O.D. _{CN} > **4**
4. Relación: O.D. _{P75} / O.D. _{CN} > **5.5**
5. Control Positivo: debe ser ≥ **40BU/ml**

Cálculo de los resultados

Método manual utilizando un papel milimetrado:


1. Situar los valores de la absorbancia (OD) de los tres calibradores (P10, P50 y P75) en el eje Y frente a sus concentraciones correspondientes (BU/ml) en el eje X.
2. Dibujar la línea recta que se ajuste mejor a los tres puntos.
3. Extrapolar el valor de la concentración de cada una de las muestras (en BU/ml) a partir de sus valores de absorbancia, utilizando la curva estándar (ver ejemplo 1).

Ejemplo 1: Interpolación de los resultados:

El valor de la absorbancia de la muestra se sitúa en el eje Y, y se dibuja a partir de este punto una línea horizontal hasta la curva de calibración.

Se dibuja una línea vertical desde el punto de corte hacia el eje X.

Leer la concentración en BU/ml de la muestra indicada en el eje X.

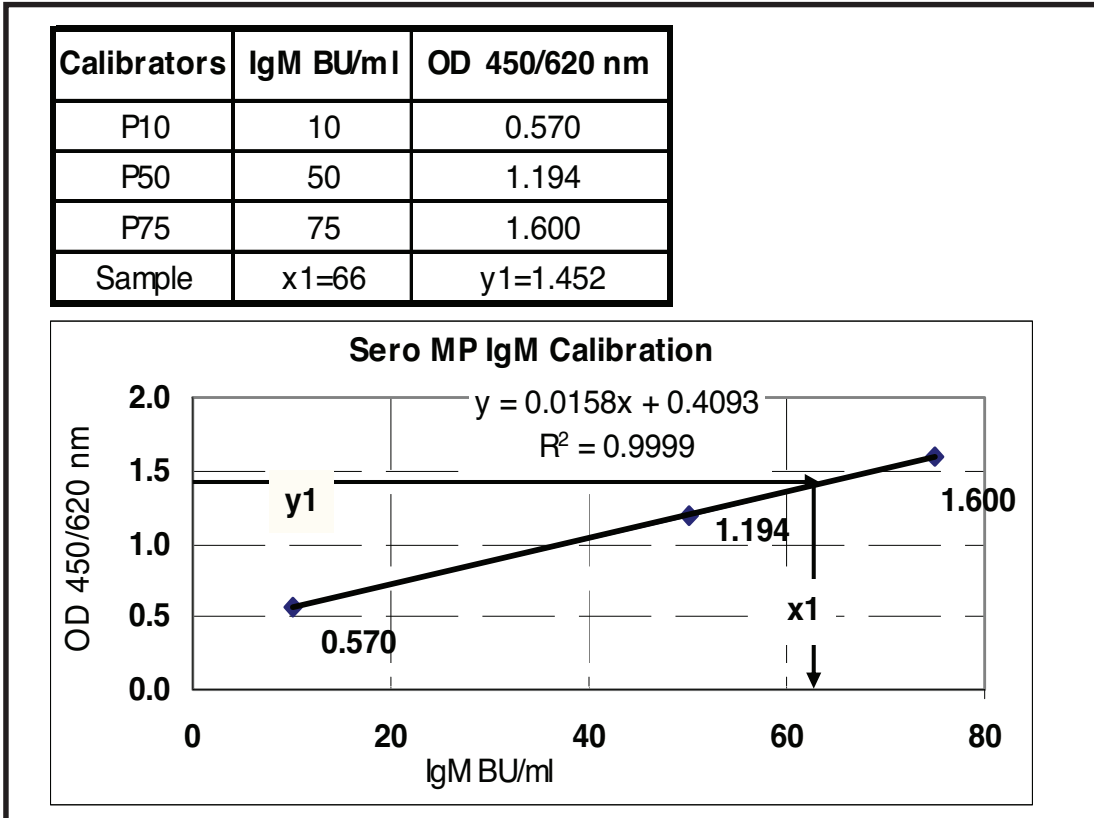

Interpretación de los resultados:

IgM BU/ml	Result	Interpretación Diagnóstica
< 10BU/ml	Negativo Nivel no detectable de anticuerpos IgM	No hay indicación de infección por <i>M. pneumoniae</i>
≥ 10 BU/ml ≤ 20 BU/ml	Límite	Ensayar una segunda muestra, tomada de dos a tres semanas más tarde. Cuando la segunda muestra de un resultado límite, deberá ser considerada como negativa.
> 20BU/ml	Positivo Nivel relevante de anticuerpos IgM	Indicativo de infección actual por <i>M. pneumoniae</i>

Se deberá realizar un ensayo para IgG e IgA con el objeto de conseguir un perfil completo de los anticuerpos.

Interpretación de los resultados basados en la combinación de anticuerpos IgM, IgG e IgA

Nivel de anticuerpos frente a <i>M.pneumoniae</i>			
IgG	IgM	IgA	
Negativo	Negativo	Negativo	Sin indicar infección por <i>M.pneumoniae</i>
Negativo o Positivo	Positivo	Negativo o Positivo	Indicativo de infección actual
Positivo	Negativo	Negativo	Indicativo de infección pasada
Negativo o Positivo	Negativo	Positivo	Indicativo de infección actual o reinfección

Reacción cruzada

Pacientes hospitalizados con infecciones en el tracto respiratorio a causa de patógenos como: *Chlamydia pneumoniae*, *Influenza A.*, *Influenza B.*, *Parainfluenza 1,2 y 3* así como *Adenovirus* y *EBV* según diagnóstico por kits serológicos comerciales, fueron evaluados también con el ensayo SeroMP. La mayoría de los sueros fueron encontrados negativos, no habiendo detección significativa de reacción cruzada.

Limitaciones del Ensayo

1. No debe realizarse únicamente un ensayo serológico para establecer un diagnóstico final. Deben tenerse en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio.
 2. Las muestras extraídas tempranamente en una infección primaria, pueden no contener cantidades detectables de anticuerpo. Si se sospecha una infección por *Mycoplasma*, se deberá extraer una segunda muestra transcurridas 2-4 semanas y ensayarse en paralelo con la muestra original.
 3. Sustancias que interfieren: No se recomienda la utilización de sueros lipémicos, turbios o contaminados. La presencia de partículas o precipitados en el suero, puede conducir a resultados erróneos. Se recomienda clarificar las muestras por centrifugación o filtración antes de comenzar con el ensayo.
-

Características del ensayo

Sensibilidad y Especificidad

La sensibilidad y especificidad de SeroMP^{MR} IgM fue calculada utilizando sueros que han sido ensayados en dos ensayos comerciales con resultados concordantes (resultados en consenso), utilizando 22 sueros obtenidos de enfermos de neumonía y 21 pacientes de donadores de sangre sanos.

		Resultados consenso	
		Positivo	Negativo
SeroMP TM IgM	Positivo	21	0
	Negativo	1	21

Sensibilidad: $21/22 \times 100 = 95\%$

Especificidad: $21/21 \times 100 = 100\%$

Concordancia: $42/43 \times 100 = 98\%$

Precisión

Intra-ensayo (ensayo simultáneo):

Muestra	No. de Repeticiones	Promedio	CV%
Positivo	10	1.341	3.4%
Negativo	10	0.243	4.3%

Inter-ensayo (ensayos repetidos):

Muestra	No. de Repeticiones	Promedio	CV%
Positivo	10	1.302	4.4%
Negativo	10	0.330	8.6%

Bibliography

1. Liberman D., Schlaffer F., Boldur I., Liberman D., Horowitz S., Friedman, M.G., Leioninen M., Horowitz O., Manor E. and Porath A. (1996) Multiple pathogens in adult patients admitted with Community - aquired pneumonia, a one year prospective study of 346 consecutive patients Thorax 1996 51: 179-184.
2. Okada T., Kato I., Miho I., Minami S., Kinoshita H., Akao I., Kemmochi M., Miyabe S. and Takeyama I (1996) Acute Sensorineural Hearing Loss Cause by *M. Pneumoniae* Acute Otolaryngol (Stockh) 1996 522: 22-25
3. Lieberman, D., Shvartzman, P., Lieberman, D., Ben-Yaakov, M., Lazarovich, Z., Hoffman, S., Mosckovitz, R., Ohana, B., Leinonen, M., Luffy, D. and Boldur I. (1998) Etiology of Respiratory Tract Infection in Adults in a General Practice Setting. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 17: 685-689.
4. Raisanen S.M. Suni J.I. and Leinikki P.O.: (1980) "Serological diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* infections by enzyme immunoassay" : J.Clin. Pathol. 33, 836-840.
5. Seggav J.S., Sedmark G.V. and Krup V., (1996) Isotype-specific antibody responses to acute *M. pneumoniae* infection Ann Allergy Asthma Immuno. 77: 67-73.
6. Samra Z., and Gadba R.,(1993) "Diagnosis of *Mycoplasma pneumoniae* infection by specific IgM antibodies using a new capture-enzyme-immunoassay; Eur. J. Epidermol. 9: 97-99.
7. Lieberman, D., Lieberman, D., Printz, S., Ben-Yaakov, M., Lazarovich, Z., Ohana, B., Friedman, M.G., Dvoskin, B., Leinonen, M. and Boldur, I. (2003) Atypical Pathogen Infection in Adults with Acute Exacerbation of Bronchial Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 167: 406-410.
8. Lieberman, D., Leiberman, D., Ben-Yaakov, M., Shmarkov, O., Gelfer, Y., Varshavsky, R., Ohana, B., Lazarovich, Z. and Boldur, I. (2002) Serological evidence of *Mycoplasma pneumoniae* infection in acute exacerbation of COPD. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 44: 1-6.
9. Lieberman, D., Leiberman, D., Ben-Yaakov, M., Lazarovich, Z., Ohana, B., Friedman, M.G., Dvoskin, B., Leinonen, M. and Boldur, I. (2003) Age and Ageing 32: 95-101.

10. Lieberman, D., Leibman, D., Koronsky, I., Ben-Yaakov, M., Lazarovich, Z., Friedman, M.G., Dvoskin, B., Leinonen, M. Ohana, B., and Boldur, I. (2002). A comparative study of the etiology of adult upper and lower respiratory tract infections in the community. *Diagnostic Microbiology and Infectious Disease*. 42: 21-28.
11. Lim, T.H., Muhlestein, J.B., Carlquish, J.F., Ohana, B., Lipson, M., Horne, B.D., Anderson, J., L. (2002). *Mycoplasma Pneumoniae* High IgA Titer but Not IgG Predicts Increased Hazard of Death or Myocardial Infarction Among Patients with Angiographically Defined Coronary Artery Disease. Abstract presented at the 51st Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, March 17-20, 2002. Atlanta, Georgia.

M262-01S 04-10/13



SAVYON DIAGNOSTICS Ltd.
3 Habosem St. Ashdod 77610, Israel
Tel: 972.8.8562920 Fax: 972.8.8523176
e-mail: support@savyondiagnosics.com



Obelis s.a. (European Authorized Representative)
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel.: +32.2.732.59.54 Fax.: +32.2.732.60.03
e-mail: mail@obelis.net